分子生物学实验室仪器设备功能简介

		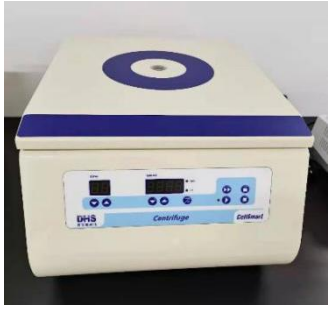	

		Thermo SCIENTIFIC NANODROP 2000	
		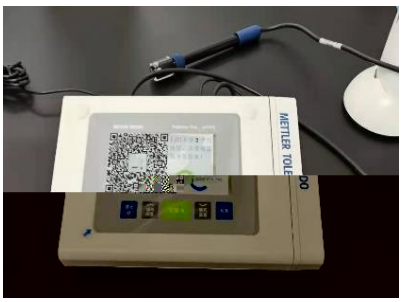 METTLER TOLEDO	
		Orbital Shaker TS-2 Speed Speed Display Power Kylin-Bell Lab Instruments	
		ROTATOR Angle setting range: 0-90°	

		eppendorf	
		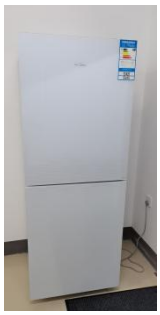	

		Milli-Q M	
		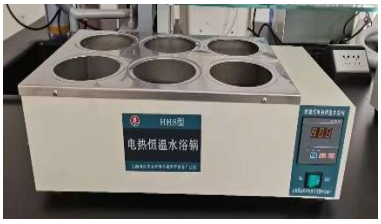 HHS型 电热恒温水浴锅	

		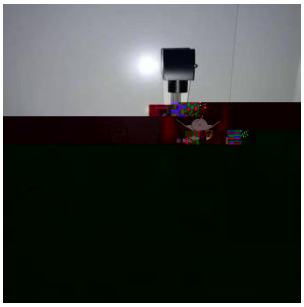	
		Thermo	
		Boxun	
		FUME HOOD	

1			22 9
2			15 (Hb) (HCT)

3			Lacate-Scout 15 250
4			
5			PH

6			
7	RT-9200		
8			
9			FVC FEV1 FEV1/FVC
10			,

1	MAX-II		1 2

2	ergoselect 1200		Ergoline Ergoline1200EL 0-45 0-45
3	ergoselect 400		Polar

4	h/p/cosmos		-5^0~$+25^0$ RS323 ECG VO2max 42 80 km/h(50 mph)
5	Myon320		1 2 sEMG
6	MicroFET3		

7	Ergoline		Polar

8	ConTrex MJ+TP1000		1 20 2 3 4 5

运动生物力学实验室仪器设备功能简介

1	LUKOtronic -As200		1 LUKOtronic 2 NI-DAQ EMG EEC ECG 3 3D

2	LUKOtronic		1 X Y Z 2
3	simi	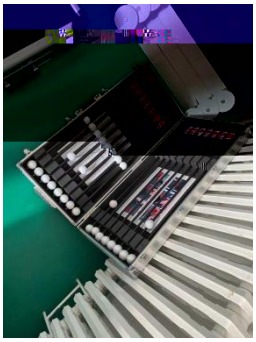	1 2 3

4	MVN		1 2 3 6
5	KoreBalance	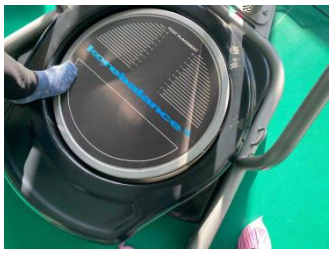	1 2 3 4 5

6	BTE EcentronPrimus		1 / 2 / 3 / 4
7	ConTrex MJ+TP1000		1 20 2 3 4 5

8	Myon320	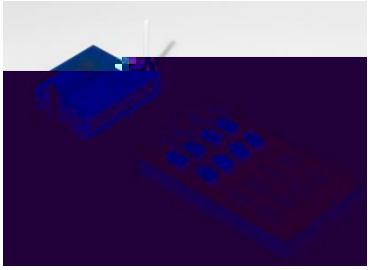	1 2 sEMG

运动康复实验室仪器设备功能简介

		AMETEK WARNING	
		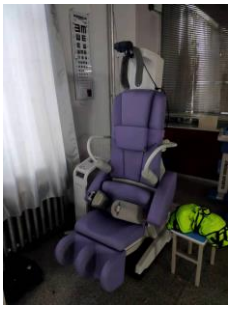	

1			( ), (BMI,) (/ :), ( )
2			50 800/1000
3			

4	X		BMD BQI

运动心理学实验室设备功能简介

1	2.0	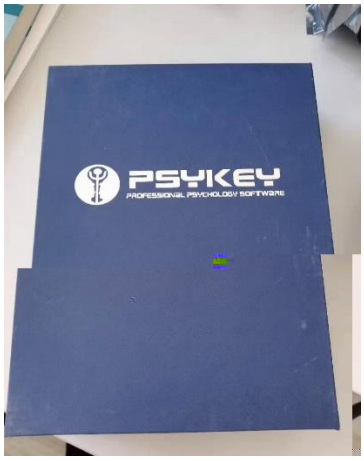	
2			
3			

冬残奥课题购买仪器设备功能简介

		皮脂厚度計	